Hygiène Prévention et Contrôle de l'Infection
Unité HPCI, Vaud

Stérilisation - Placement des éléments de contrôle (indicateurs)

F Fiche technique

Mode de stérilisation			
	Programme de stérilisation		
Vapeur	☐ Prions	134°C	18 min.
	☐ Plastique	121°C	20 min.
Gaz EO	☐	55°C	60 min
	☐	42°C	2 h30
V2O2 (Plasma)	☐		
Charge	☐ à vide		
	☐ de référence		

Charge		
Date	**Heure**	**Identification du stérilisateur**
Collaborateur (nom/code identifiant):		

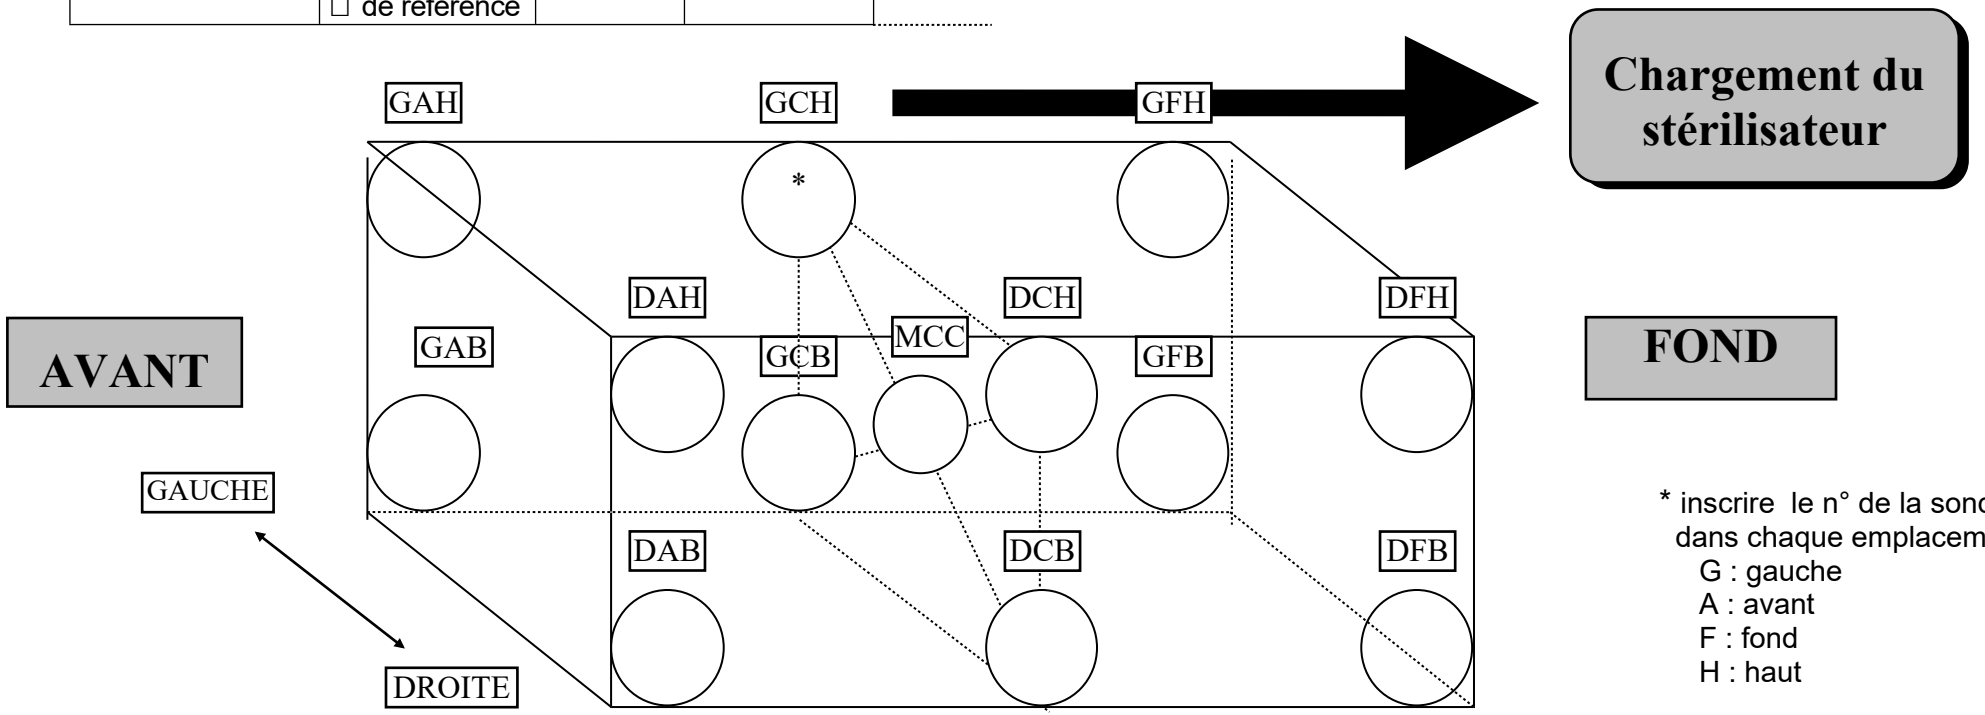

* inscrire le n° de la sonde dans chaque emplacement utilisé
G : gauche
A : avant
F : fond
H : haut